Disponible a través de:

ACS

Alcohol Countermeasure Systems
acs-latam.net

Fabricado en Canadá por
Alcohol Countermeasure Systems Corp

Garantía

Los productos de ACS están garantizados contra defectos de fabricación y materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Cualquier mantenimiento se debe realizar sólo por técnicos capacitados.

ACS, ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, ALCOSIM, ALERT y "Molly" son marcas comerciales de Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. y se usan bajo licencia.

ALERT™ J4X

Alcoholímetro Profesional

20190501

ACS
ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

Prueba confiable en la palma de su mano

ALERT J4X es un alcoholímetro portátil fiable, perfecto para la seguridad industrial y la fuerza policial, los cuales requieren resultados precisos. Detenga el alcohol al volante desde el origen con este compañero portátil.

Funcionamiento intuitivo

Nunca confundirá los resultados gracias a su interfaz intuitiva fácil de entender. Los iconos en pantalla le guiarán en el proceso de la prueba de alcoholemia. Tanto principiantes como profesionales valoran las capacidades y la facilidad de uso de este alcoholímetro al realizar su trabajo.

Resultados con código de colores

El puerto de la boquilla se ilumina en tres colores diferentes para indicar el rango de medición junto con una lectura de tres dígitos en la pantalla. Verificación de alcoholemia simple y precisa.

Sensor confiable

ALERT J4X utiliza un sensor electroquímico: el estándar para los alcoholímetros de control de tráfico, lo que garantiza la estabilidad y la precisión.

Su seguridad, nuestra promesa

Con las certificaciones ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO/IEC 17025 e ISO 17034, garantizamos la alta calidad del diseño y la fabricación de todos nuestros productos y servicios, manteniendo el equilibrio y el respeto por el medio ambiente. Nuestro compromiso con la seguridad, la calidad y el servicio al cliente definen nuestro liderazgo en la industria.

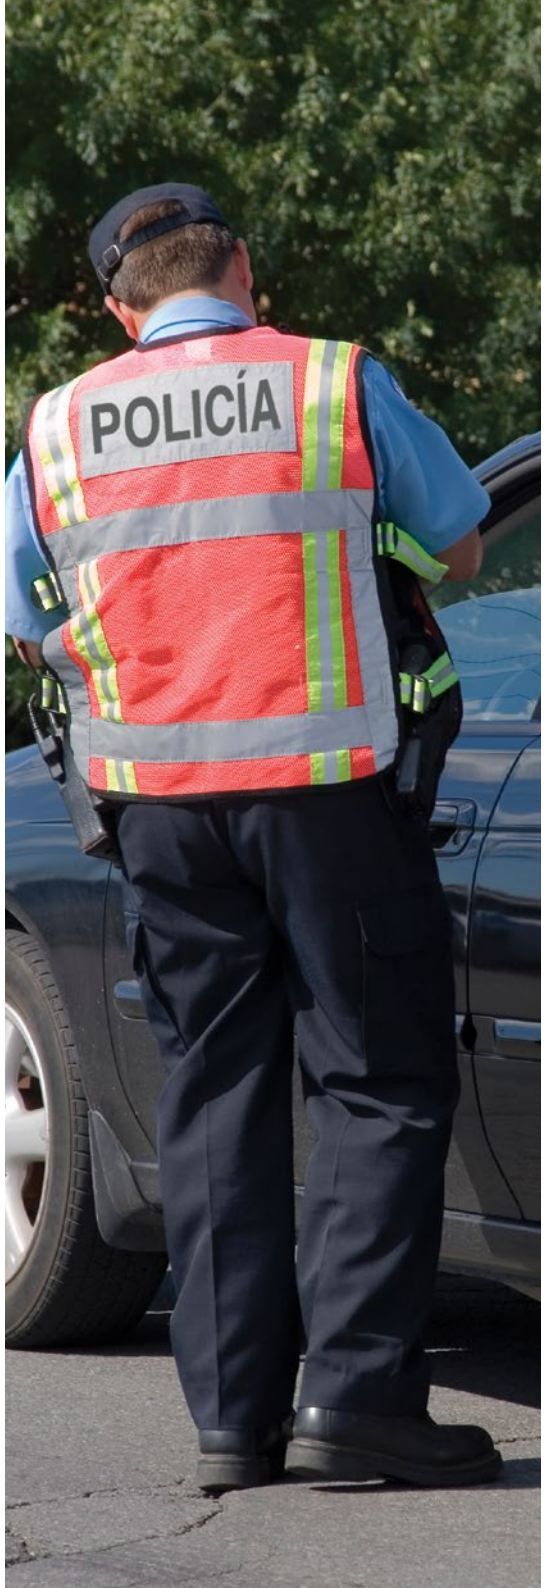

Sensor
Electroquímico

Especificidad
Únicamente alcohol; no responde a cetonas o hidrocarbonos.

Rango de medición
0 a 2,50 mg/L

Unidad de medida
mg/dL, g/dL, g/L en la sangre
mg/L, µg/dL, µg/L en el aliento

Tiempo para iniciar la prueba
5 segundos

Tiempo de análisis
< 10 segundos

Tiempo para reiniciar el ciclo
5 segundos

Precisión
± 0,03 en 0,50 mg/L

Pantalla
LCD gráfica

Temperatura de funcionamiento
-20 °C a +50 °C

Batería
2 AA alcalinas

Calibración
Simulador de alcohol en aliento ALCOSIM™ o equivalente

Dimensiones
135 mm x 59 mm x 30 mm

Peso
162 gramos